PGJ5E3019 REV1 07/2015

i·sens

الدليل المرجعي السريع

CareSens™ N

نظام مراقبة جلوكوز الدم

1. جهاز قياس جلوكوز الدم CareSens N

ملحوظة: ينصح بالتأكد مما إذا كانت شاشة العرض في جهاز القياس تكون مطابقة للشكل أعلاه في كل مرة يشتغل فيها الجهاز. ولا تستخدم جهاز القياس إذا كانت شاشة العرض لا تطابق تماما الشكل حيث أن الجهاز قد يعرض نتائج غير صحيحة.

2. شريط اختبار CareSens N

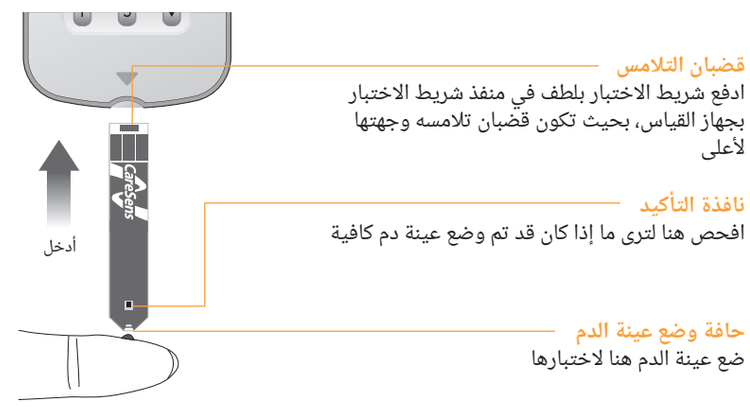

3. وسيلة أخذ عينة الدم

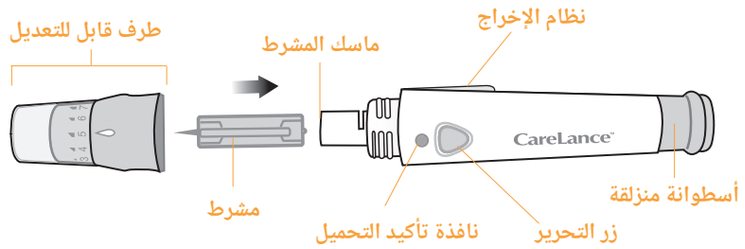

4. إعداد وسيلة أخذ عينة الدم

1. فك الطرف القابل للتعديل وأزله.



2. أدخل بإحكام مشرطا جديدا في ماسك المشرط. امسك المشرط بإحكام. لف بلطف لتسحب للخارج القرص الواقي. احتفظ بالقرص لتغطي المشرط بعد الاستعمال. أعد تركيب طرف وسيلة أخذ عينة الدم.



3. اختر العمق المطلوب من واحد إلى سبعة (1 - 7) على الطرف القابل للتعديل لوسيلة أخذ عينة الدم. اختر عمقا بلف الجزء العلوي من الطرف القابل للتعديل حتى يتطابق رقم الضبط مع السهم. ينصح في البداية باستخدام الضبط ثلاثة (3).



4. جهز وسيلة أخذ عينة الدم بسحب الأسطوانة المنزلقة حتى تتعشق الوسيلة مصدرة صوتا.



5. إعداد جهاز القياس وشريط الاختبار

5. اغسل يديك واغسل موضع أخذ العينة. اشطفهما وجففهما تماما.



6. أدخل شريط اختبار بحيث تكون قضبان التلامس وجهتها لأعلى. سيظهر الرمز على الشاشة.

6. وضع الدم

7. خذ عينة دم باستخدام وسيلة أخذ عينة الدم.



8. بعد ظهور الرمز على الشاشة، ضع عينة الدم على الطرف الضيق لشريط الاختبار حتى يصدر جهاز القياس صوتا. وإذا لم تمتلئ نافذة التأكيد في الوقت المناسب بسبب اللزوجة غير العادية (الثخانة واللزوجة) أو لعدم كفاية الكمية، فقد تظهر الرسالة Er4.
ينصح بإجراء وضع عينة الدم على شريط الاختبار ظاهريا في وضع عمودي بالنسبة لمكان العينة كما هو موضح في المخطط.



عينة غير كافية — عينة جيدة

9. ستظهر نتيجة الاختبار بعد أن يعد جهاز القياس عدا تنازليا من 5 إلى 1. ستخزن النتيجة تلقائيا في ذاكرة جهاز القياس.

7. التخلص من المشارط المستعملة

10. ضع الغطاء الواقي على الإبرة.



11. ادفع مُخرج المشرط للأمام بالإبهام للتخلص من المشرط المستعمل في حاوية للنفايات ذات الخطر البيولوجي ملائمة.



8. شاشة العرض والرسالة

شريط الاختبار الذي تم إدخاله مستعمل.
> كرر الاختبار بشريط اختبار جديد.

تم وضع عينة الدم أو محلول التحكم قبل ظهور الرمز.
> كرر الاختبار بشريط اختبار جديد وانتظر حتى يظهر الرمز قبل وضع عينة الدم أو عينة محلول التحكم.

درجة الحرارة أثناء الاختبار كانت أعلى أو أقل من مدى التشغيل.
> انتقل إلى منطقة تكون درجة الحرارة فيها ضمن مدى التشغيل (5-50 درجة مئوية/41-122 درجة فهرنهايت) وكرر الاختبار بعد أن يبلغ جهاز القياس وأشرطة الاختبار درجة حرارة ضمن مدى التشغيل.

عينة الدم لزوجتها عالية على نحو غير سوي أو حجمها غير كاف.
> كرر الاختبار بعد إدخال شريط اختبار جديد.

قد تظهر رسالة الخطأ هذه عند استعمال شريط اختبار خطأ لفحص جلوكوز الدم بدلا من شريط اختبار CareSens N.
> كرر الاختبار بواسطة شريط اختبار CareSens N.

توجد مشكلة في جهاز القياس.
> لا تستخدم جهاز القياس. اتصل بوكيل مبيعات i-SENS المعتمد.

حدث خطأ إلكتروني أثناء الاختبار.
> كرر الاختبار بشريط اختبار جديد. إذا استمرت رسالة الخطأ، اتصل بوكيل مبيعات i-SENS المعتمد.

تظهر الأيقونة **HI** عندما يكون مستوى جلوكوز الدم أكثر من 33.3 ملي مول/لتر وفرط سكر الدم.

تظهر الأيقونة **Lo** عندما يكون مستوى جلوكوز الدم أقل من 1.1 ملي مول/لتر وفرط سكر الدم.

CareSens™ N

الدليل السريع

i-SENS, Inc.
43, Banpo-daero 28-gil, Seocho-gu,
Seoul 06646, Korea
www.i-sens.com

الموزع في أستراليا: Pharmaco (Australia) Limited
Gordon, NSW 2072
هاتف: 1800 114 610
موقع الويب: www.caresens.com.au

الموزع في نيوزيلندا: Pharmaco (NZ) Ltd
Auckland
هاتف: 0800 GLUCOSE (0800 458267)
موقع الويب: www.caresens.co.nz

© 2015 i-SENS, Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

IVD CE 0123